BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Terminal 5** **Incheckningsdisk 4**
Provningsdatum	

Objekt

Kategori **Elektronisk**		**Serienr** **17f0393**
Fabrikat **Flintab**	**Modell** **47-10**	**Kunds märkning**
Kapacitet(kg)	**Skaldelsvärde(ex 0,1)**	

Mätmetod **Jämförande mätning med verifierade viktnormaler**

Spårbarhet **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0	0	0	
10,0	10,1	0,1	10	
20,0	20,5	0,5	20	
30,0	30,9	0,9	30	
40,0	40,8	0,8	40	

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A

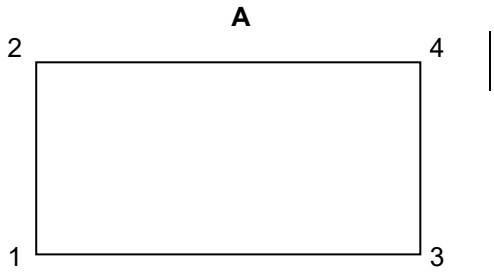

Övriga noteringar:

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20,6	10
2	20,5	10
3	20,5	10
4	20,3	10

Provad av:

Swedavia	**Datum** **2026/11/19**